

AD-5763-150
AD-5763-200
AD-5763-300

防滴デジタルノギス
取扱説明書 保証書付

1WMPD4001277

ご注意

- (1) この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはできません。本書の内容の一部、または全部の無断転載は禁止されています。
(2) この取扱説明書の記載事項および製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
(3) 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、お気付きの点がございましたらご連絡ください。
(4) 運用した結果の影響については、前項にかかわらず責任を負いかねますので御了承ください。

はじめに

このたびはAD-5763シリーズ 防滴デジタルノギスをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、保証書も兼ねておりますので、お読み頂いた後も大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

この機器を操作するときは、下記の点に注意してください。


注意

- ・万一、電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師の指示を受けてください。
・本製品各部の端やとがった部分は鋭利になっております。けがをしないように取り扱いには十分注意してください。
・修理
ケースを開けての修理はサービスマン以外行わないでください。保証の対象外になるばかりか、機器を損傷および機能を失う恐れがあります。
・機器の異常
機器の異常が認められた場合には、速やかに使用をやめ、「故障」であることを示す貼紙を機器につけるか、あるいは誤って使用されることのない場所へ移動してください。そのまま使用を続けることは大変危険です。修理に関しては、ご購入店、または弊社にお問合せください。

取り扱い上の注意

- 本製品は完全防水タイプではありませんので、水に濡れた状態では正しい測定ができません。水に濡れた場合は、直ちに表示部を何回かスライドさせながらスケール部分の水を完全に拭き取ってください。
●本製品の耐水性は、JIS及び国際規格IECに規定された等級IP54です。IP54：ちり・ほこりなどの固体に対して5級（1mm未満のちりの侵入を完全ご防止することは出来ない、器具の所定の動作および安全性を阻害する量のちりの侵入がないこと＝防じん形）、水に対して4級（いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないもの＝防まつ形）
●強い衝撃や振動、電氣的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
●急激な温度変化のある所、高温、多湿やほこりの多い所、また直射日光が当たる所の使用は避けてください。
●スケールに傷をつけないでください。故障の原因になります。
●3ヶ月以上使用しない場合は本製品から電池を取り外して保管してください。電池の液漏れにより故障の原因になります。

1. 各部の名称

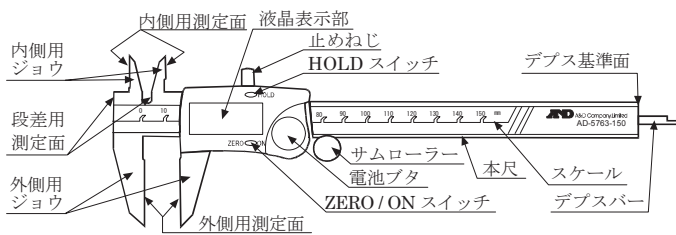

1-

2. 測定方法

- ・ゼロ設定を行った後、外側測定面を閉じたときにマイナス表示が出る場合があります。これはエラーではありません。
・測定する際は、本体測定部で必要以上の力を測定物に対して加えると正しく測定できません。
・使用後は、本体に付着した汚れや水分などをふき取り、付属プラスチックケースに入れて保管してください。

- ① ZERO / ON スイッチ（電源スイッチ）を押し電源を入れます。
② 外側測定面を閉じた状態で ZERO / ON スイッチ（ゼロ点設定スイッチ）を押します。
③ 「3. 各部の使用方法」を参考に測定します。
④ 測定後、約3分30秒間何も操作しないと表示が消えます。

2-

保証書


この製品が、取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じた場合は、保証期間内に限り無償にて修理・調整をさせていただきます。

Form for warranty registration including fields for product name (防滴デジタルノギス), model number (AD-5763-150/AD-5763-200/AD-5763-300), customer name, address, purchase date, and company information (AND 株式会社 エーアンドデイ).

3. 各部の使用方法

外側測定


外側測定面で測定物をはさみ測定します。そのとき、外側測定面の中央部ではさみ、外側測定面に測定物が密着（直角）するようにサムローラーで調整してください。



測定物：■

内側測定

内側測定面を測定部分に差し込み測定します。そのとき、内側測定面の奥まで差し込み、内側測定面に測定部分が密着（直角）するようにサムローラーで調整してください。




測定物：■

3-

段差測定


段差測定面を測定部分に差し込み測定します。そのとき、段差測定面の中央部ではさみ、段差測定面に測定物が密着（直角）するようにサムローラーで調整してください。



測定物：■

深さ測定

デプス基準面を測定部分に密着（直角）させ、デプススプーを挿入します。デプススプーを使った測定は不安定なため、測定部分が十分広いときは、段差測定面を使った段差測定を行ってください。



測定物：■

4-

4. 各種機能

スリープモード

本製品は、約3分30秒間何も操作しない状態が続くと電池の消耗を防ぐためスリープモードになります。スリープモードを解除し再び電源を入れるには、ZERO/ON スイッチ（ゼロ点設定スイッチ）または HOLD スイッチを押してください。

ゼロリセット

測定中に ZERO/ON スイッチ（電源スイッチ）を押すと、その時点の表示値がリセット（ゼロ点に設定）されます。この機能を利用することで、間接測定や比較測定などが可能となります。

データホールドモード (HOLD)


測定中にホールドスイッチ (HOLD) を押すと、その時点の表示値をホールド (固定) することができます。再度、ホールドスイッチ (HOLD) を押すか、または電源を入れ直すとデータホールドモードは解除され、現在の測定値が表示されます。

5-

5. 電池の交換方法

本製品は、CR2032（リチウム電池）を1個使用しています。表示が出なくなったり、または点滅したり薄くなった場合、使用を中止して下記の方法で電池を交換してください。※付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。

電池の交換方法（下記の数字順）



注意

- 1. 電池は必ず指定のものを使用してください。
2. 電池の極性を正しくセットしてください。
3. 充電、ショート、分解、火中への投入はしないでください。
4. 電池は絶対に口に入れないでください。万が一飲み込んだ場合は、直ちに医師の指示を受けてください。
5. 環境保全のため、使用済み電池は、市町村の条例に基づいて処理するようお願いします。

6-

6. お手入れ

汚れた場合は、乾いた柔らかい布で表面を拭き取ってください。お手入れの際、水や洗剤、揮発油などの溶剤・薬品・研磨剤などを直接本体につけたり、かけたりしないでください。

7. メンテナンス

故障かな？と思ったら

Table with 2 columns: Symptom (e.g., '表示が点滅する'), Cause (e.g., '電池が消耗しています'), and Solution (e.g., '新しい電池と交換してください').

※万一、本製品が正しく動作しなくなったときには、システムリセットすることができます。リセットするには、一度電池を外し、30秒放置してから電池を入れ直してください。

7-

8. 仕様

Technical specifications table including measurement range (0-150mm to 0-300mm), accuracy (±0.01mm), resolution (0.02mm), and battery life (approx. 1 year).

8-

保証規定

万一、本製品を用いたことにより損害が生じた場合の賠償は本製品の購入代金の範囲とさせていただきます。また、次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。

- 1. 誤ったご使用または取扱いによる故障または損傷。
2. 保管上の不備によるもの、及びご使用者の責ご帰すと認められる故障または損傷。
3. 不適切な修理や改造によるもの、破損、外装損傷、付属品の交換。
4. 火災、地震、水害、異常気象、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
5. 保証書の提示がない場合。
6. 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは文字が書き換えられた場合。
7. ご使用後の修理や改造、破損、外装損傷、付属品の交換。
8. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
9. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

AND 株式会社 エーアンドデイ logo and contact information: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14 (ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F) TEL.03-5391-6126 FAX.03-5391-6129